电子床头卡 产品手册_V1.0

M-BS03



● **产品概述**

□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□

● **功能特点**

- ➢ □□□□□□□□□□□□□□□
- ➢ □□□□□□□□□
- ➢ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□
- ➢ □□□□□□□□□□□□
- ➢ □□□□□□□□□□□□□□□
- ➢ □□□□□□□□

●

□□□□□□□ □□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□μA

□□□□□□□

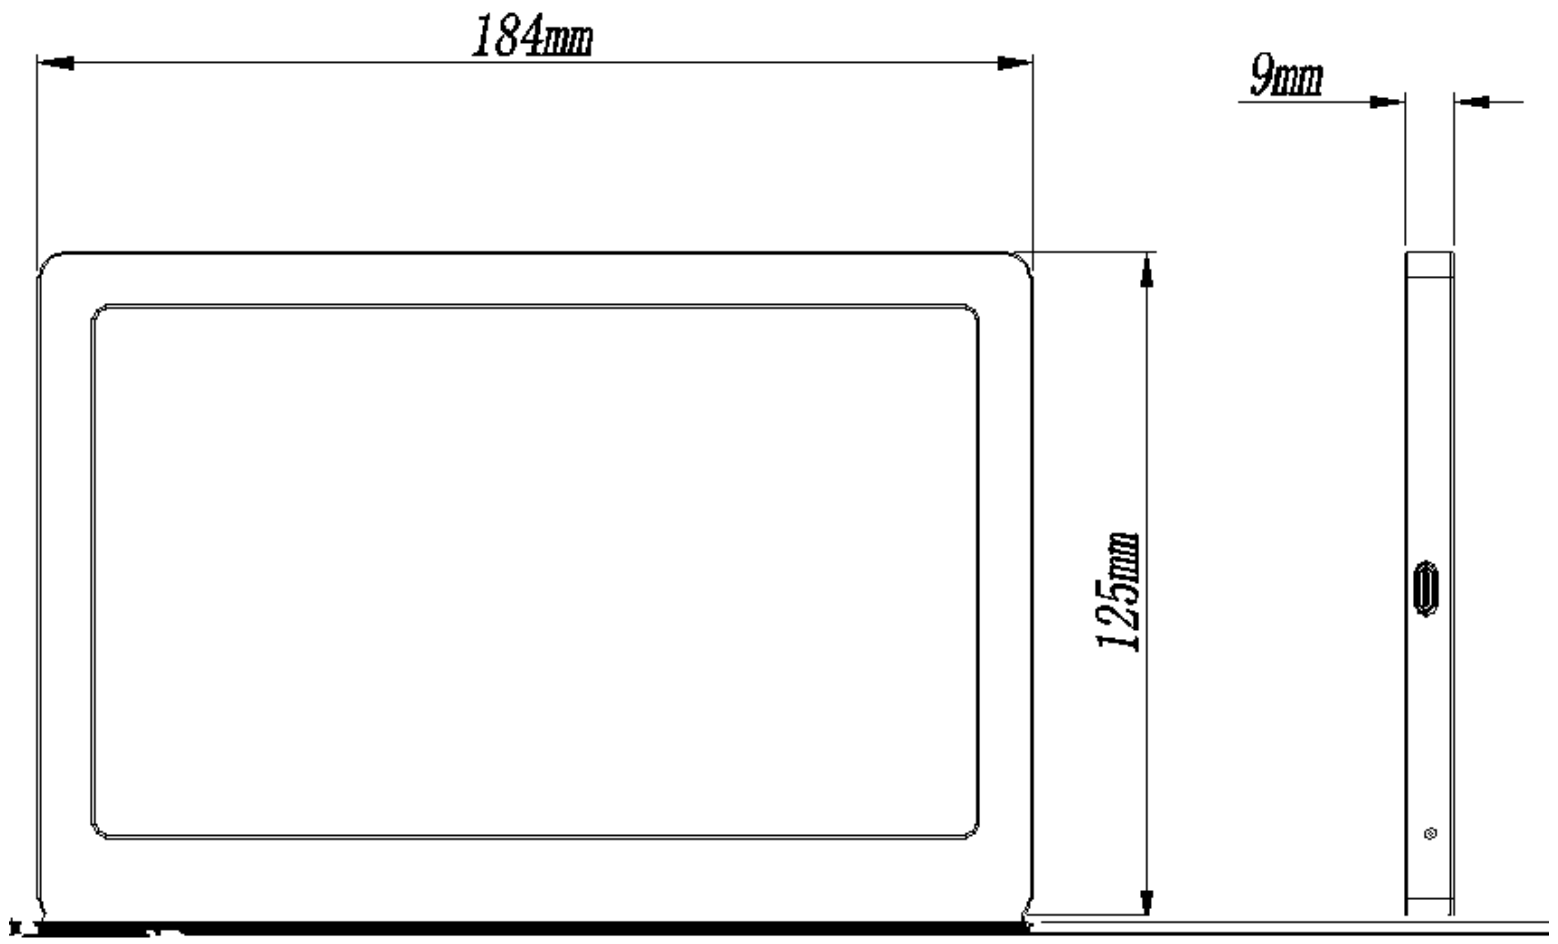
□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□


● **产品**

□□□□(L×W×D): 184×125×9 mm



● □ □ □ □

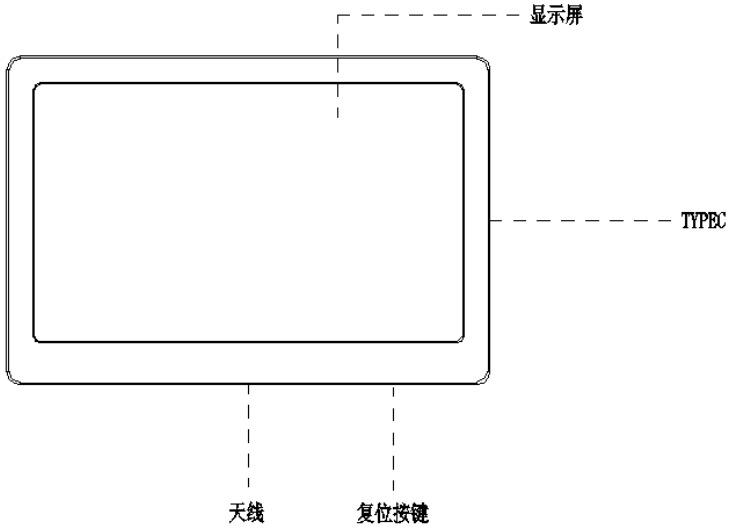外



Type-c 充电接口；

天线 用于增强 LoRa 信号；

复位按键 用于复位。

用 示、

本产品需 人员配置好电子床头卡系 。

患者信息、

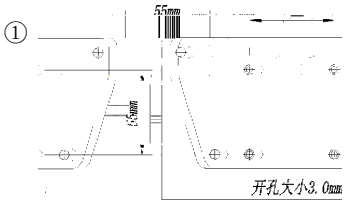
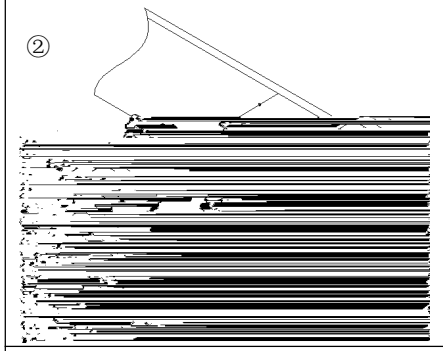
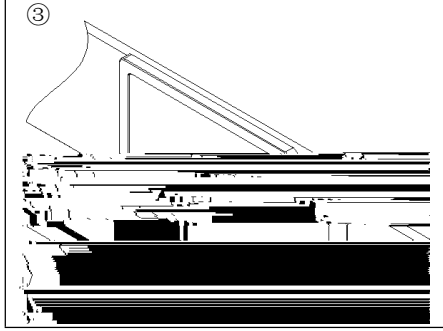
1、医护人员 医院系 入、 患者信息；

2、电子床头卡 自动 新 入、 的患者信息。

电 电 、

后台服务器可查看电子床头卡电池的使用情况。

● □ □ □ □

① 	第一步 设备带 按图 1 挂 的 距离 。
② 	第第二步 用螺丝 挂 固定 设备带 ，然后 设备固定 挂 即可 成安装。
③ 	第三步 安装 成后的状态。