ą ′Y

´ ε



M ↓ _V1.0

M-BS08

注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境，



2、不要将设备摔落在地上或使之受到强力冲击；

2.3 ٥
3.1 h
3.2 ٤
3.3
3.4 ٩
3.5 ٢
3.6

W̃ W

ç M ↓ ´ ε , G TCP/IP D ٦ ˘ ۞̃ ت
˘ IC à ID غ NFC ┘ ٧ w Â Ḥ
à r à ï à ᵽ à Ḥ à ٨˘ Ḥ à ض à
à l w ˘ ᴸ Ḃ ≠˘ ٦ ٧ ¸ 2 ƀ Â

à

˘

WIFI à

500W ″E

ID à IC ï NFC ┘ ٧

ï ت


4G w ^ L~

ت ^ L~


Hu ᵃᵖ ᵉ :

2.1ᵃᵖ ᵉ



001 王桂兰
2019-08-23 星期五
10:48:29
呼叫
费用查询
检查报告
体征采集
满意度调查
护理信息
计时器

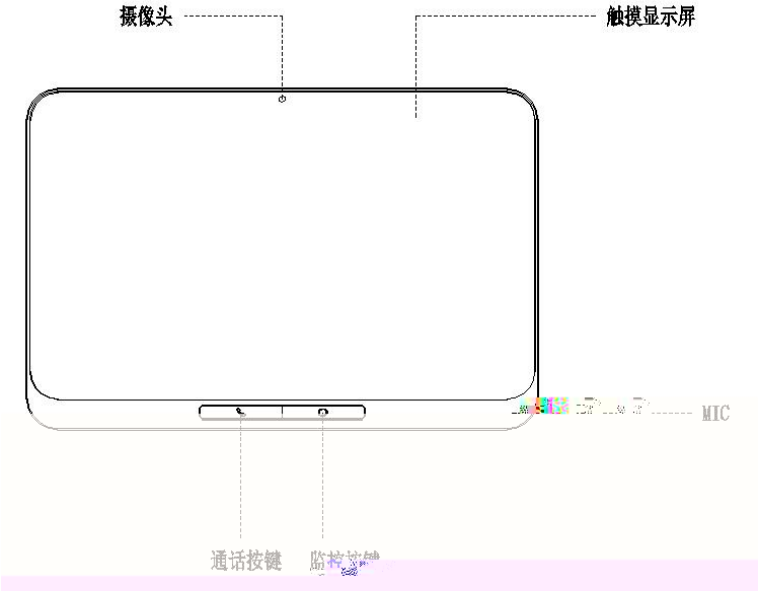
摄像头
触摸显示屏
MIC
通话按键

2.2 ㅌ ㅈ

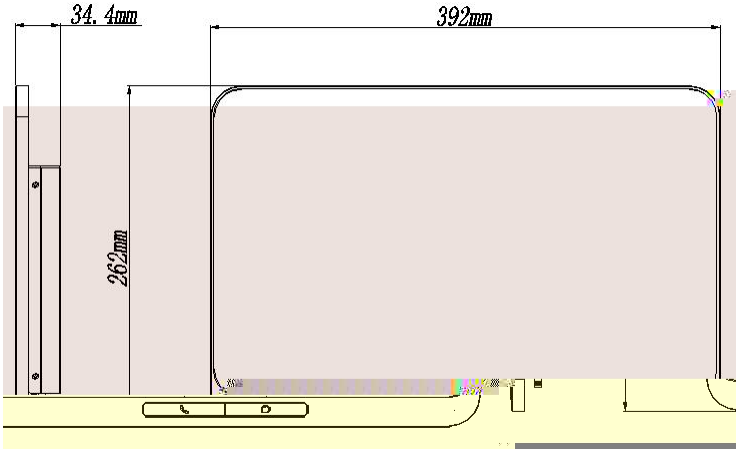


2.3 ㅇ

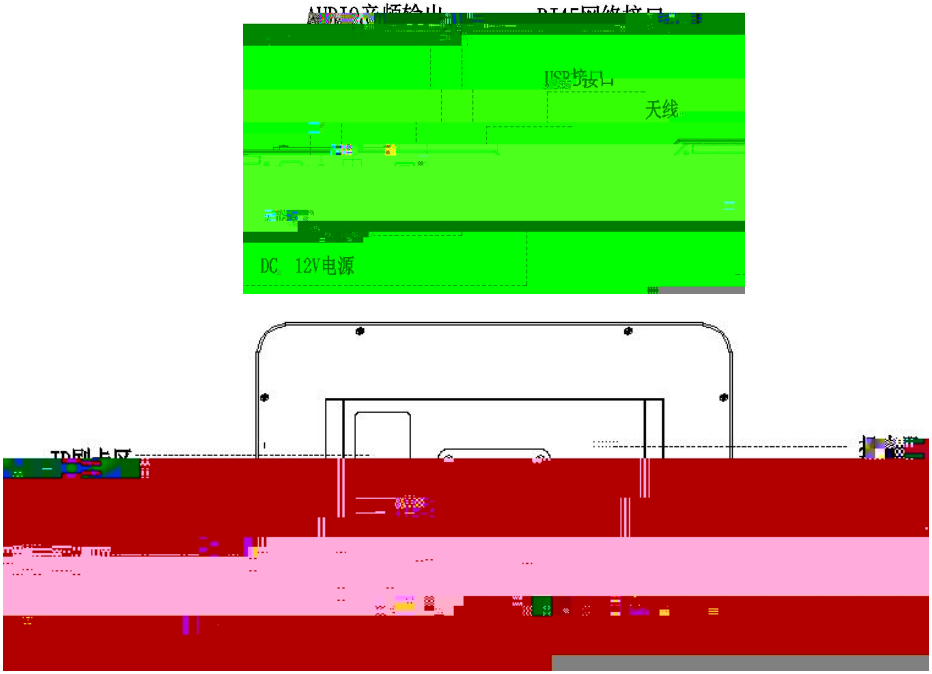

3.1 h



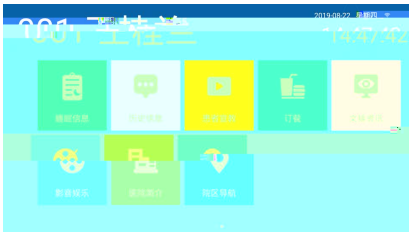

h 1 h 2

ت

Ð呼叫 ぇ ˘ ˆ ت ´ ε Â

Ð费用查询 ぇ ˘ ˆ Ỵ Â

ᵽ

Ð检查报告 ぇ ˘ ˆ Ỵ ᵽ Â

r

Ð体征采集 ぇ ˘ ˆ Ỵ r Ť Ϸ Â

Ð满意度调 ぇ ˘ ˆ Ỵ Ⱶ №Â

Ḥ

Ð护理信息 ぇ ˘ ˆ Ḥ à ˜ ᵀ ˤ à ˤ ئم Ḥ ǐ Â

ᶎ

Ð计时器 ぇ ˘ ˆ Ϙ W Â


设置


睡眠信息


历史信息


患者宣教


订餐


文娱资讯





医院简介


院区导航

3.2 ع ´ ع

h Ð ρ 呼叫 ي ˇ ˜ ع ´ ع Â ~ ع ˇ ڈ ي Â

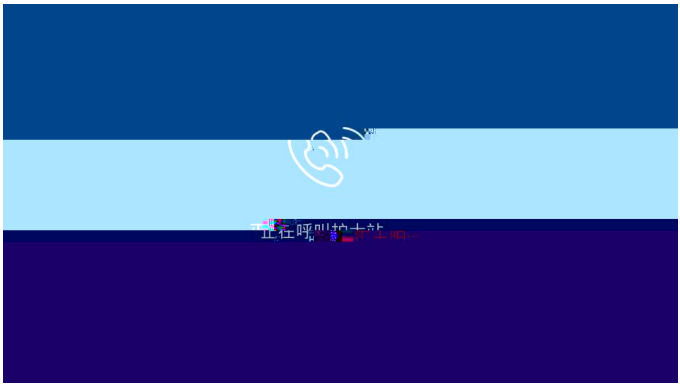


ع ´ ع

Ð ρ ˇ 3˜ ع ´ ع Â

Ð ρ ˇ ع ' Ð ρ ˇ ع Â

3.3


h Ð ρ 费用查询 ي ˇ ~ Â

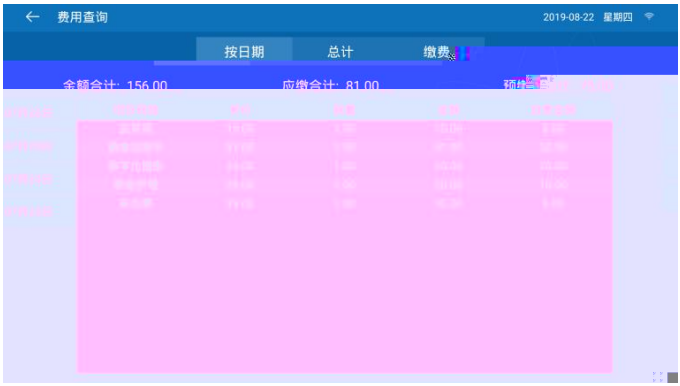

Ð ρ 按日期 ぇ ˘ ˆ ，

Ð ρ 总计 ぇ ˘ ˆ ，

Ð ρ 缴费 ぇ ˘ ˆ È Ù Â

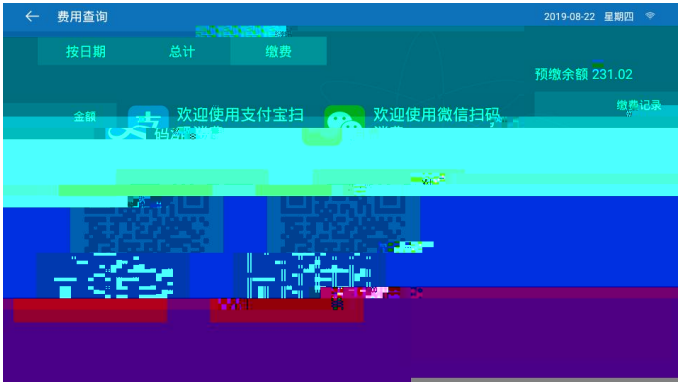

3.4 Þ

Ð ρ 检查报告 ぇ ˘ ~ Þ ˘ ˆ Ỳ Þ ｲ Â




Þ

3

3.7 Ḥ

h Ɗᵨ 护理信息 ᵡ˳ ˇ ~ Ḥ ˇ ˆ Ḥ à ~ ᵀ ᵞ à ᵞ ᵚ

Ḥ ǐ Â

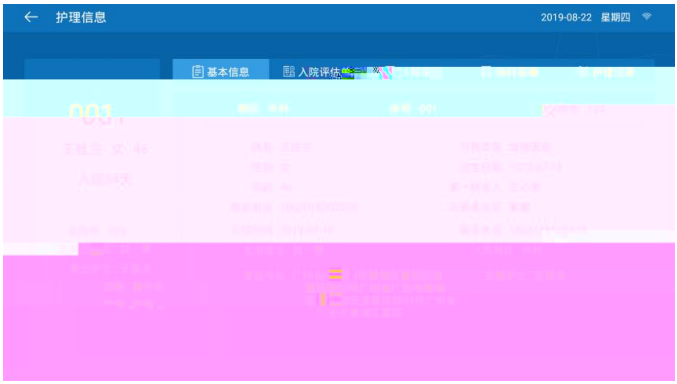

Ḥ

3.8 h˗

Ɗᵨ ´ ε h ¬ ↓ ˇ U Ɗᵨ ¬ ᵡ˳ ˇ ˆ ¬ Ь ҥ

ˇ / ₀ ˇ Ɗᵨ ₀ ˆ ŋ Â



h˗

3.9









3.11 ﾍ ﾋ

Ɗρ 历史信息 ﾈ ˇ ~ ﾍ ﾋ Ḥ ˇ ˜ Ḥ Â

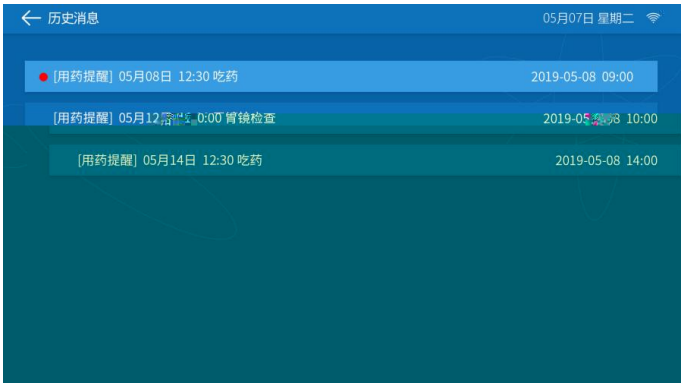


ﾍ ˇ Ḥ

Ч ˇ Ɗρ ˇ ˜ Â

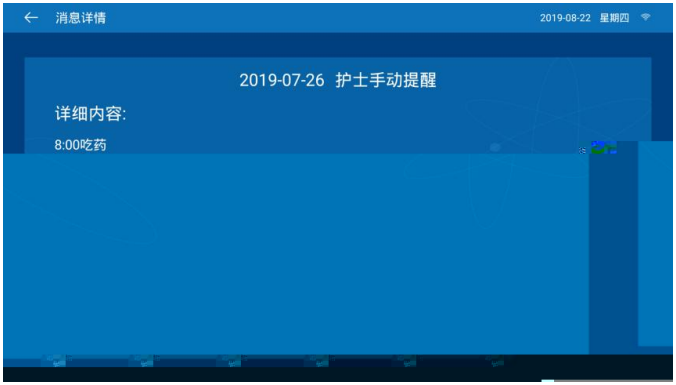

3.12

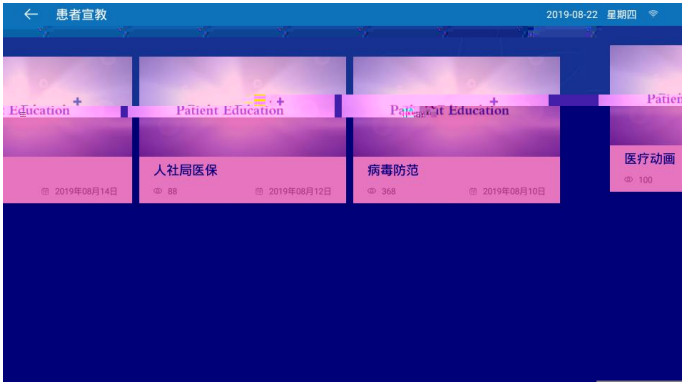
患者宣教
2019-08-22 星期四
Education
Patient Education
Patient Education
Patien
人社局医保
2019年08月14日
88
2019年08月12日
病毒防范
368
2019年08月10日
医疗动画
100

3.13


订餐
2019-08-22 星期四
¥ 8.0
¥ 9.0
咸骨粥
¥ 6.0
排骨焖饭
15元套餐

3.14




文娱资讯
2019-08-22 星期四
网页
新闻
音乐
视频
图片
贴吧
地图

3.15 l




影音娱乐
2019-09-11 星期三
网络视频
本地视频
VIDEO
VIDEO
VIDEO
医疗动画
人社局医保
病毒防范

/

3.16 Ⅵ :


Ɗ医院简介 ᵴ ˘ ~ Ⅵ : ˘ ˆ ᵀ : Â



Ⅵ :

3.17 Ⅵ

Ɗ院区导航 ᵴ ˘ ~ Ⅵ ˘ ˆ Ⅵ ᵴ Â

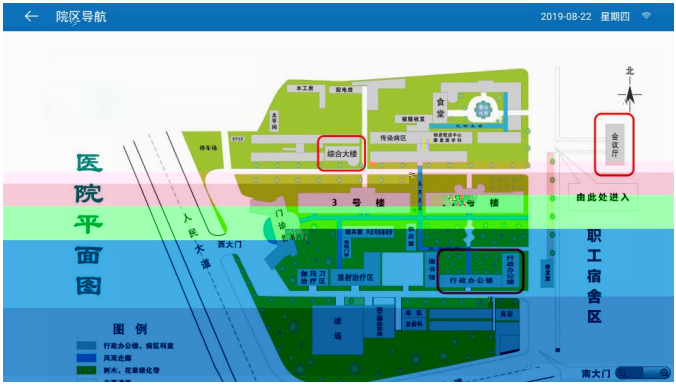


Ⅵ


ضه

4.1

h Ð  ﺯ ˇ ~ Â

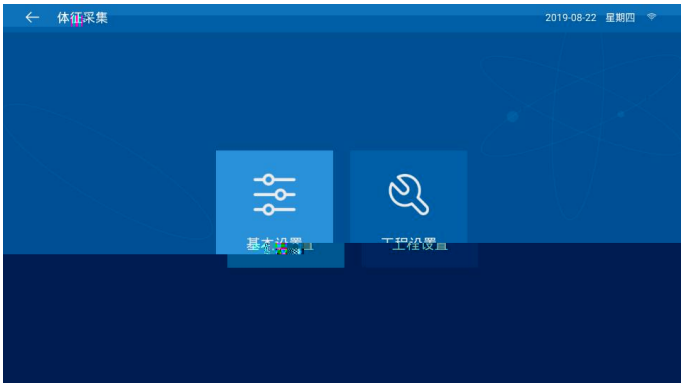


~ ˆ ч 2718˜ ˇ ~ Â

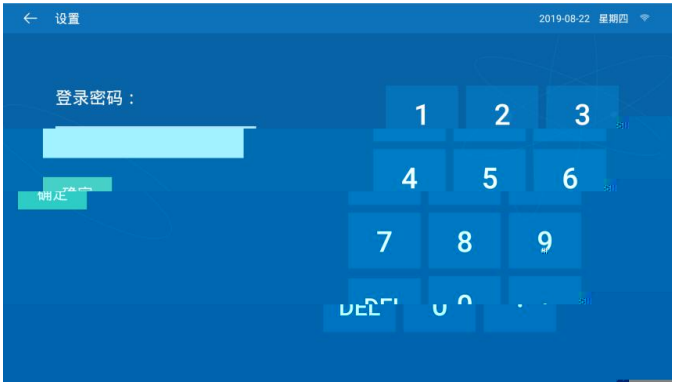

Ð

ъ˘ ~ ˘ ˜ ˘ Ø à ï

h Â

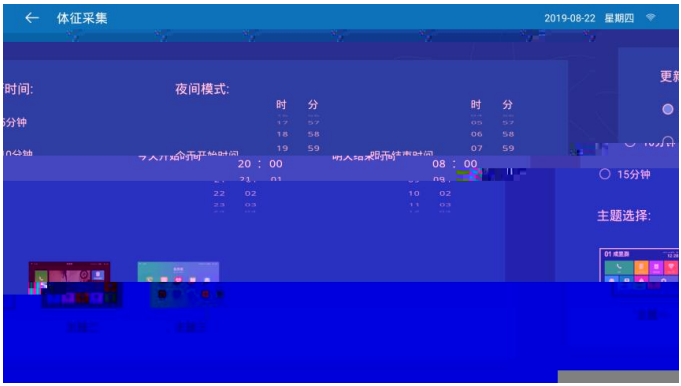

Ð

ъ˘ ~ ^ Ч 2718˜ ~ Â



˜ Ⱶ ȿ à ₀ à IP à ˜ ˘ Ð ρ Ḡ Â

4.2 ƒ ∧

ض Ð 关于 ב ˇ ~ ˀ G Â




ˀ G

ˀ G ˆ Ð à ˆ à ˆ à IP à o à Ḥ ˇ Ð 恢复出厂设置 ב

ˇ ˆ ƒ ∧ Â

Л

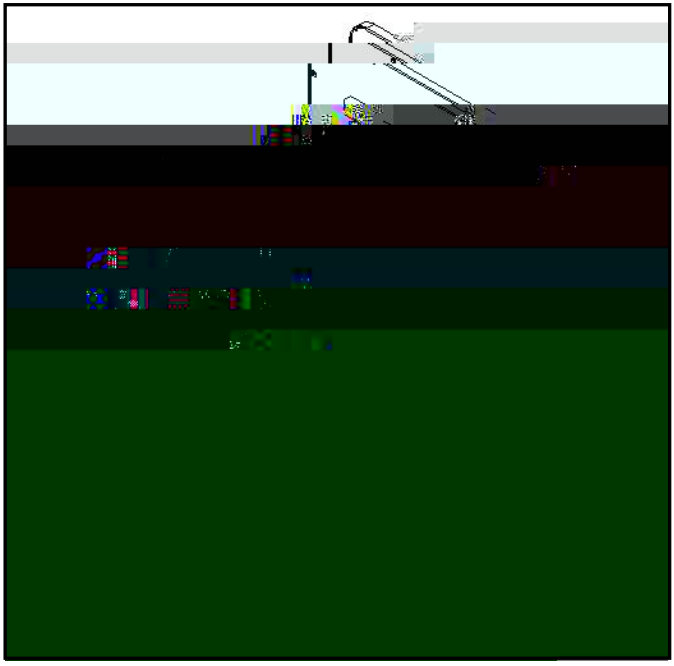

غ ‰ β U˘ 4 ۞ ۷˜ Â